

報告書番号 APT-4

アスベスト分析技能試験報告書

建材中のアスベスト定性分析技能試験
(試験所対象)

<概要版>

建材中のアスベスト定性分析
JIS A 1481-1

2019年 5月

一般社団法人 日本環境測定分析協会

〔はじめに〕

建材中のアスベスト分析は、アスベスト含有量の規制値の改正に伴い分析方法の変更が重ねられてきたが、2014年3月、国際的な規格に整合した JIS A 1481-1:2014 建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第1部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法が制定された。

国際規格に対応した規格となったが、従来のアスベスト分析に使用していなかった偏光顕微鏡を用いた分析法であるため、熟練した分析者の育成が急務であった。一般社団法人 日本環境測定分析協会（以下、日環協）では、2013年度から ISO 22262-1、及び JIS A 1481-1 に基づいた定性分析トレーニングプログラムを実施し、2018年度までに延べ約 350 試験所、440 名の技術者に対して実技研修を行ってきた。このような講習会や技能向上のためのプログラム参加とともに、外部精度管理として試験所間比較試験や技能試験への参加が信頼性の確保と精度管理のために有用である。

日環協では、外部精度管理の一環として、1999年度より環境分析分野の技能試験を、当初は国際規格 ISO/IEC Guide 43 (JIS Q 0043)、2012年度以降は国際規格 ISO/IEC 17043 (JIS Q 17043) に基づいたマネジメントシステムにより実施している。これと同様なスキームにより、日本初のアスベスト分析技能試験として「建材中のアスベスト定性分析技能試験（試験所対象）」を 2014年度より継続的に実施し、2017年度までに延べ 118 試験所が参加している。その第4回として本技能試験を実施し、結果をとりまとめて本報告書に示した。

1. アスベスト分析技能試験の実施概要

1.1 実施機関

一般社団法人 日本環境測定分析協会

〒134-0084 東京都江戸川区東葛西2丁目3番4号

TEL 03-3878-2811 FAX 03-3878-2639

ただし、均質性試験は、外部委託した。

1.2 試験項目および実施期間

試験番号：APT-4

試験名：建材中のアスベスト定性分析技能試験（試験所対象）

試験項目：建材中のアスベスト定性分析 有姿の建材4試料

試験申込期間：2019年1月8日（火）～2月8日（金）

試料配付：2019年2月19日（火）より

報告期限：2019年3月8日（金）

報告は1試験所1報告に限る

1.3 分析方法

JIS A 1481-1：2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第1部

：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法

1.4 参加状況

アスベスト分析技能試験（試験所対象）の参加状況を表1に示す。

表1 参加試験所数と報告数

参加試験所数	報告数
55	55

1.5 報告の方法

参加試験所から、以下の内容・項目を記載したエクセルワークシートを電子メールで受領し、結果報告とした。報告に用いられた様式を資料4「分析結果報告シート」として添付する。

【一般項目】

受験番号、試験所名、試料名、分析日、室温

【実体顕微鏡観察項目】

均一性、状態、色、繊維の有無

【偏光顕微鏡観察項目】

アスベスト含有の有無（含有の場合はアスベストの種類）、アスベスト含有量（目視による判定として、0.1-5%、5-50%、50-100%で記載）、形態、多色性の有無、消光（直消光、斜消光）、伸長の符号、使用した浸液の屈折率、分散色、波長（||）波長（⊥）、非アスベスト繊維、コメント

1.6 合否判定の方法

本技能試験における合否判定について、アスベスト技能試験（APT）委員会において、米国及び英国の3つの技能試験（表2）の評価方法を比較検討した結果、米国 NVLAP の評価基準を参考として決定した実技試験評価基準（表3）を用い、減点方式で評価することとした。判定基準として減点（評価点）の合計が150未満の試験所を合格とすることとした。

表2 実施されているアスベスト技能試験の例

国	実施機関	プログラム名	制度形態
米 国	NIST (National Institute of Standards and Technology)	NVLAP (National Voluntary Laboratory Accreditation Program) 技能試験プロバイダーは RTI International 社	試験所認定と技能試験
	AIHA (American Industrial Hygiene Association)	BAPAT (Bulk Asbestos Proficiency Analytical Testing program)	技能試験
英 国	FPTSC (Fiber Proficiency Testing Steering Committee)	AIMS (Asbestos in Materials Scheme)	国際試験所間比較技能試験

表 3 実技試験評価基準

評価項目	評価点
一種類のアスベストを含有する試料に対して、含有されているアスベストを報告していない	150
アスベスト不含有の試料に対して、アスベスト含有と報告	150
複数種類のアスベストを含有する試料に対して、含有されているアスベストを全く報告していない	150
一種類のアスベストを含有する試料に対して、含有されているアスベストを報告したが、含有されていないアスベストも報告	75
複数種類のアスベストを含有する試料に対して、含有されているアスベストをすべて報告したが、含有されていない種類のアスベストも報告	75
複数種類のアスベストを含有する試料に対して、一部のみを報告(漏れがある)	75
多色性の有無	10
消光 (直消光/斜消光)	10
伸長の符号	10
報告された光学的性質の矛盾	10
合格と判定する評価基準	150 未満

2. 試料

2.1 試料の概要

本試験に用いた 4 種類の試料について、カナダの Chatfield Technical Consulting Ltd. に、ISO-22262-1 に基づく建材中アスベストの定性分析を依頼して得られた結果を表 4 に示す。

これらの試料は、解体・除去現場から採取し、分割又は分取した有姿の建材である。試験実施に際し、4 種類の試料を試験所ごとに番号を付したセットとして配付した。なお、試料の分割又は分取は、日環協の分析室において、アスベストの飛散及び試料間のコンタミネーションを防止するため HEPA フィルター付フード内で実施した。

表 4 試料の概要

試料名	E	F	G	H
試料	天井吸音板	白色ボード	ケイ酸カルシウム板 1 種	吹付材 (パーライト)
アスベストの種類	クリソタイル	ND	アモサイト クリソタイル	クリソタイル
含有率 (%)	0.1-5%	-	0.1-5% 0.1-5%	5-50%

注) JIS A 1481-1 は定性分析法であり、含有量 (%) は参考値である。

2.2 配付試料の均質性

配付試料の均質性を確認するため均質性試験について、本技能試験実施期間以降に実施した。均質性試験に用いた試料は、実技試験試料調製の際に、4 種類の試料から各 5 検体を無作為に抽出したものである。均質性試験に際して技能試験で用いた試料名と異なる名称を付した。これらの試料について JIS A 1481-1 に基づく定性分析を行うこととして、国内参照試験所に依頼して分析を行った。均質性試験結果 (表 5) に示される通り、各試料から抽出した 5 検体の分析結果は一致し、試料の均質性が確認された。

表 5 配付試料の均質性試験結果

試料	検体 1	検体 2	検体 3	検体 4	検体 5
E	クリソタイル	クリソタイル	クリソタイル	クリソタイル	クリソタイル
F	ND	ND	ND	ND	ND
G	アモサイト クリソタイル	アモサイト クリソタイル	アモサイト クリソタイル	アモサイト クリソタイル	アモサイト クリソタイル
H	クリソタイル	クリソタイル	クリソタイル	クリソタイル	クリソタイル

【国内参照試験所】

国内参照試験所は、当協会が実施しているアスベスト偏光顕微鏡実技研修のインストラクターが所属する下記の試験所である。

- ・ (株)アサヒテクノロジー
- ・ (株)EFA ラボラトリーズ
- ・ 中外テクノス(株)
- ・ 非営利特定法人 東京労働安全衛生センター
- ・ アスカ技研(株)
- ・ (株)環境管理センター
- ・ (株)東海テクノ

2.3 付与値について

本技能試験の実技試験で配付した試料について、Chatfield Technical Consulting Ltd. による分析結果（表 4）と、均質性試験の結果（表 5）を照合して相違が無いことを確認し、表 4 における「アスベストの種類」（不含有の場合は「ND」と表記）を付与値とした。

2.4 配付試料の記録

試験に用いた試料（分割・分取前、及び配付時）の画像を写真 1～写真 4 に示す。



写真 1 試料 E



写真 2 試料 F

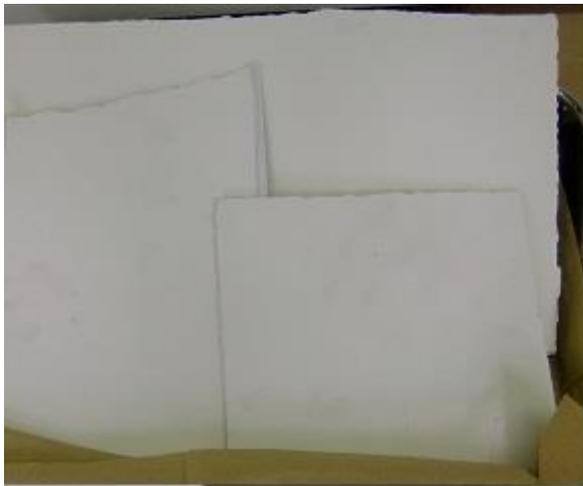


写真 3 試料 G

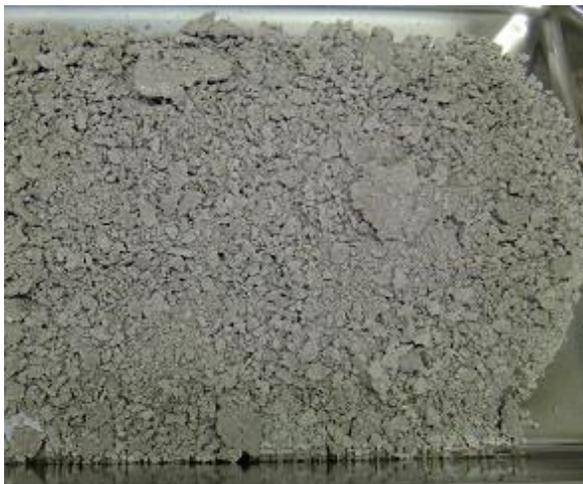


写真 4 試料 H